



# Microscopio Prisma 208-T

(MTP104126)





<b>Sección</b>	<b>Contenido</b>	<b>Página</b>
<b>1</b>	<b>Introducción</b>	2
<b>2</b>	<b>Información técnica</b>	2
2.1	Especificaciones técnicas	2
2.1.1	Objetivos	2
2.1.2	Oculares	2
2.1.3	Ampliación total	3
2.1.4	Tamaño de platina, tipo de condensador, rango de enfoque e iluminación	3
2.2	Características	4
2.3	Componentes	6
<b>3</b>	<b>Instrucciones de uso</b>	7
3.1	Instalación	7
3.1.1	Condiciones ambientales	8
3.1.2	Conexión eléctrica	9
3.2	Advertencias	10
3.3	Operación	13
3.3.1	Funcionamiento	13
<b>4</b>	<b>Mantenimiento</b>	15
4.1	Guía de solución de problemas	15
4.2	Mantenimiento preventivo	17
<b>5</b>	<b>Garantía limitada</b>	18
5.1	Políticas de garantía limitada	18
<b>6</b>	<b>Anexos</b>	23
6.1	Aplicaciones del microscopio	23
6.2	Ficha técnica	24

# 1. Introducción

El Microscopio Prisma 208-T, es un instrumento óptico trinocular de diseño moderno de brazo en arco que puede adaptarse a cabezales binoculares y trinoculares inclinados a 30° y puede adaptarse a una Pantalla LCD táctil TFT para una visualización en tiempo real. Cuenta con cabezal Trinocular Siedentopf para un enfoque de alta calidad, así como revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra. La platina mecánica doble capa de alta precisión con asa larga ajustable y las perillas de enfoque coaxial macrométrico/micrométrico, facilitan su operación.

El instrumento posee un condensador tipo ABBE N.A.=1.25 con diafragma de iris para una observación detallada, objetivos planos infinitos de alta calidad, oculares de campo amplio y lámpara LED con brillo ajustable, lo cual garantiza la mejor imagen. Su base robusta, está diseñada para uso prolongado en distintos laboratorios. Es ampliamente utilizado para exámenes, demostraciones educativas, bacteriología y citoscopia en universidades, centros médicos, institutos de investigación y departamentos de silvicultura y agricultura, entre otros.

## 2. Información Técnica

### 2.1 Especificaciones técnicas

#### 2.1.1 Objetivos

Categoría	Aumento	Apertura numérica	Distancia de trabajo (mm)	Observaciones
Objetivos acromáticos	4X	0.11	37.5	----
	10X	0.25	7.316	----
	40X	0.66	0.632	Con resorte
	100X (Aceite)	1.25	0.198	Con resorte

Tabla 1. Especificaciones de los objetivos

#### 2.1.2 Oculares

Categoría	Aumento	Diámetro de campo de visión	Observaciones
Ocular de campo amplio	WF10X	Ø22 mm	----

Tabla 2. Especificaciones de los Oculares

### 2.1.3 Ampliación total

Oculares	Objetivos			
	4X	10X	40X	100X
	Aumento Total			
10X	40X	100X	400X	1000X

Tabla 3. Ampliación Total del Microscopio

**Nota:** La ampliación total se calcula multiplicando el aumento del ocular por el del objetivo. Con el ocular de 10X, la ampliación máxima puede alcanzar los 1000X.

### 2.1.4 Tamaño de platina, tipo de condensador, rango de enfoque e iluminación

Elemento	Especificación
Tamaño de la platina:	175 x 145mm, rango de movimiento: 76 x 50mm
Condensador ABBE, N.A.:	= 1.25 con diafragma de iris
Rango de enfoque macrométrico / micrométrico:	25 mm
Iluminación:	LED CC de 5W, brillo ajustable, diafragma de campo

Tabla 4. Especificaciones de la platina, condensador, enfoque e iluminación

## 2.2 Características

<b>Características</b>	<b>MTP104126</b>
Cabezal Trinocular Siedentopf inclinado a 30° para un enfoque de alta calidad.	•
Se adapta a cabezales binoculares y trinoculares inclinados a 30°.	•
Objetivos de plano infinito y oculares de campo amplio que proporcionan imágenes claras.	•
Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con tope de seguridad.	•
Revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra.	•
Moderno brazo en arco para una mejor visualización, ergonomía y comodidad.	•
Platina Mecánica de doble capa, con vernier y pinza para una operación fácil.	•
Objetivos con anillos de color para su fácil identificación durante su operación.	•
Iluminación Koehler LED 5W con brillo ajustable, lo que garantiza una luz eficiente y prolongada.	•
Condensador ABBE N.A.=1.25 con diafragma de iris para una observación detallada.	•
Conector que permite adaptar una Pantalla LCD y proporcionar imágenes de alta definición.	•
Base robusta, diseñado para uso prolongado para distintas áreas de aplicación.	•

Tabla 5. Características del microscopio

Elemento	Especificación	Modelo		
		Prisma 208 2da. Generación (SKU:MBP104022)	Prisma 208-T (SKU:MTP104126)	Prisma 208-LCD (SKU:MDP104134)
Objetivos Plano Infinito	4X, 10X, 40X(S), 100X(S. Aceite)	•	•	•
Ocular	WF 10X	•	•	•
Cabezal	Cabezal Binocular Seidentopf	•		
	Cabezal Trinocular Seidentopf		•	•
Revolver	Cuádruple	•	•	•
Platína	Platína mecánica de doble capa	•	•	•
Iluminación	LED 5W	•	•	•
Condensador	Condensador ABBE N.A.=1.25	•	•	•
Pantalla LCD	Pantalla LCD táctil TFT de 9.7 pulgadas			•

Tabla 6. Equipamiento estándar de la serie Prisma 208

## 2.3 Componentes

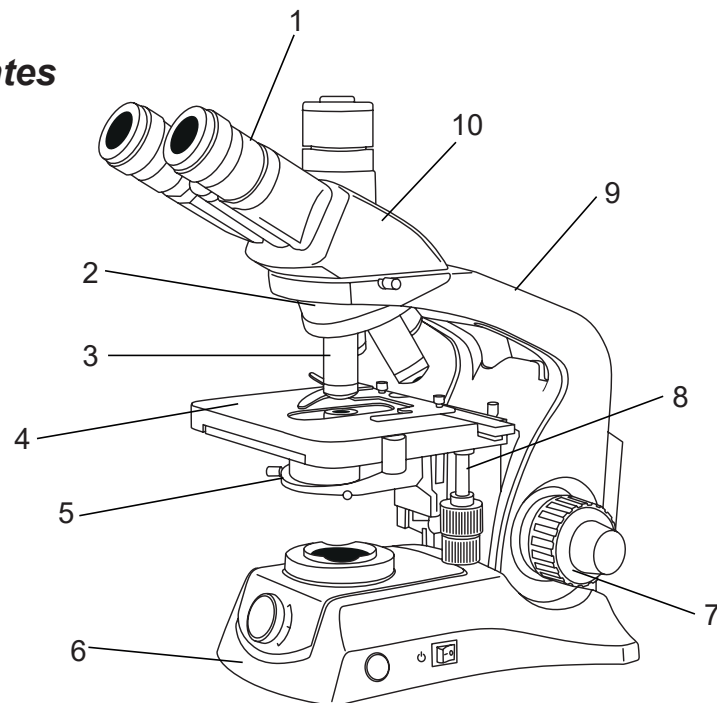


Figura 1. Estructura general del microscopio

Referencia	Nombre	Descripción
1	Oculares	Ocular de campo amplio WF10X/22mm.
2	Revólver	Cuádruple, rotación cómoda y precisa.
3	Objetivos	4X, 10X, 40X(S) y 100X (S, Aceite) de plano infinito de alta calidad.
4	Platina	Mecánica de doble capa, operación fácil con mando coaxial en posición baja.
5	Condensador	ABBE, N.A. = 1.25 con diafragma iris
6	Soporte	Es la base que soporta el peso total del microscopio, incluyendo el sistema de iluminación, partes electrónicas y control de conexión.
7	Perilla de enfoque grueso y fino	Mecanismos de ajuste del microscopio que suben o bajan la platina (o el tubo) para enfocar la muestra.
8	Soporte de subida y bajada	Sistema de enfoque que conecta la platina, el brazo y el condensador. Permite el movimiento vertical de la platina y el condensador. La platina y el condensador se mueven verticalmente a través de él para un correcto funcionamiento.
9	Brazo	Parte central que conecta el marco con los demás componentes. Incluye sistema de enfoque coaxial macrométrico / micrométrico, con ajuste de tensión y tope de límite. Asegura un movimiento suave de la platina.
10	Cabezal de observación	Acepta cabezales binoculares o trinoculares con una inclinación de 30°.

Tabla 7. Elementos del microscopio

## 3. Instrucciones de uso

### 3.1 Instalación

- 1. Desembalaje:** Compruebe que todos los componentes estén bien conectados y/o no presenten daños al abrir el paquete e instalar el microscopio. Tenga cuidado de no forzarlo demasiado, ya que podría dañarlo.
- 2. Colocación:** Coloque el cuerpo del microscopio sobre una superficie plana, estable y limpia.
- 3. Cabezal binocular:** Retire la tapa de protección del cuerpo (brazo) del microscopio. Inserte el cabezal trinocular en la parte superior y aprete el tornillo de fijación.
- 4. Oculares:** Inserte los oculares WF10X en los tubos del cabezal.
- 5. Objetivos:** Coloque los objetivos (4X, 10X, 40X, 100X) en el revolver. Enrósqelos en orden de aumento (del menor al mayor).
- 6. Platina y condensador:** Asegúrese de que la platina mecánica de movimiento esté libre y el condensador ABBE esté correctamente posicionado.
- 7. Conexión eléctrica:** Conecte a la fuente de alimentación, verificando el voltaje y encendiendo la iluminación LED de 5W con brillo ajustable.
- 8. Ajuste:** Ajuste la distancia interpupilar y el enfoque fino/grueso para la visualización.
- 9. Iluminación:** Encienda la luz y ajuste el brillo a un nivel cómodo. Ajuste el condensador ABBE (NA =1.25) y el diafragma iris para controlar la intensidad y contraste de la luz sobre la platina.
- 10. Montaje y funcionamiento de la Pantalla LCD (Opcional):**
  - a)** Conecte el adaptador C de 0.5x a la Pantalla LCD.
  - b)** Coloque el conjunto (adaptador C de 0.5x con la Pantalla LCD) en el cabezal trilocular y fíjelo con el tornillo de bloqueo.
  - c)** Para la Pantalla LCD, al encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca la imagen. A continuación, seleccione el software S-EYE para continuar (S-EYE es una aplicación de cámara para dispositivos Android. Permite ajustar los parámetros de la cámara, capturar imágenes y vídeos, y medir objetos en la imagen. Además, ofrece una función sencilla de procesamiento de imágenes para el análisis de partículas).
  - d)** Al apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido para que aparezca un cuadro como el siguiente (Figura 2):

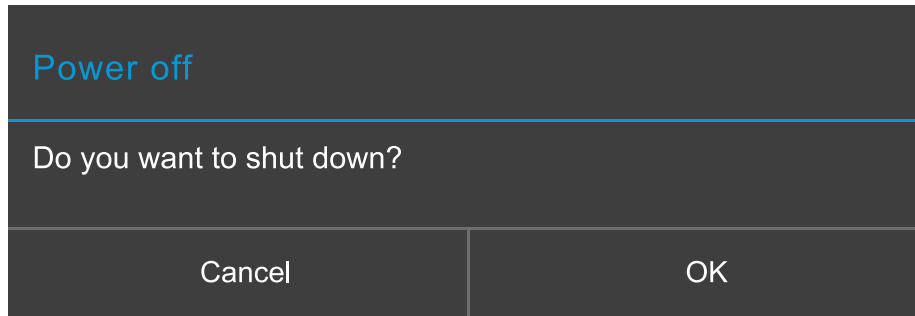


Figura 2.

- e) Después haga clic en “Ok” (Aceptar).
- f) Utilice las perillas de enfoque grueso y fino del microscopio para obtener una imagen nítida.
- g) La estructura de la pantalla LCD se muestra a continuación (Figura 3):

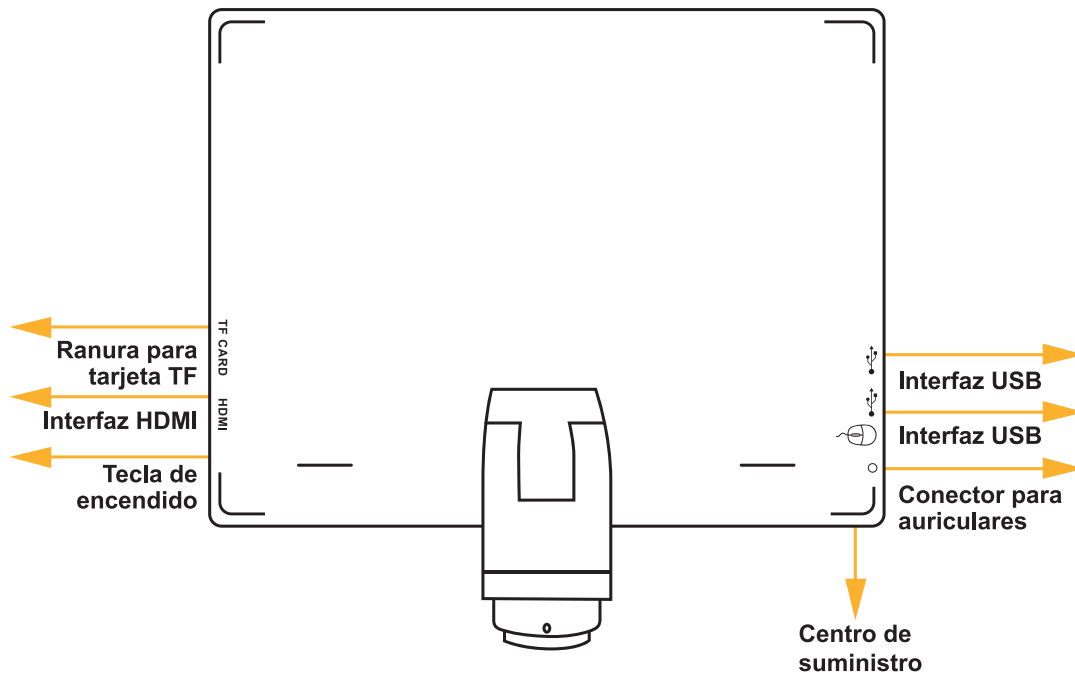


Figura 3.

### 3.1.1 Condiciones ambientales

- **Entorno de operación:** Debe utilizarse en interiores.
- **Temperatura:** Se recomienda trabajar a temperatura ambiente, evitando calor extremo que pueda afectar los componentes ópticos o la iluminación LED.
- **Humedad:** Evitar entornos excesivamente húmedos para prevenir la formación de hongos en los lentes y la corrosión de partes metálicas.

- **Limpieza:** El área de trabajo debe estar libre de polvo. Se deben usar cubiertas protectoras (guardapolvo) cuando el microscopio no esté en uso.
- **Iluminación:** El equipo cuenta con iluminación LED de 5W con brillo ajustable, por lo que no requiere condiciones especiales de oscuridad, aunque se beneficia de un ambiente controlado de luz ambiental.
- **Manejo de lentes:** No tocar las lentes con las manos y utilizar papel de óptica o material suave diseñado para su limpieza.

### 3.1.2 Conexión eléctrica

- Requisitos de alimentación: CA monofásica de 110 V / 60 Hz.
- El equipo DEBE contar con una conexión a tierra. Si la toma de corriente no tiene un extremo de tierra, el equipo debe conectarse a tierra con un conductor de tierra independiente antes de conectarlo a la alimentación.



#### **Advertencia**

- El cable de alimentación debe estar conectado al interruptor de encendido únicamente para su uso. No lo tuerza ni tire del cable, ya que podría dañarlo o aflojarlo, además de provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El equipo debe contar con una conexión a tierra fiable. No conecte el cable de tierra a tuberías de plástico, gas, agua, etc.
- Se recomienda además el uso de un supresor de picos o un regulador de voltaje para proteger el equipo contra variaciones eléctricas que puedan afectar su funcionamiento o dañar sus componentes internos.

## 3.2 Advertencias

### • Símbolos y descripción








Símbolo	Descripción
	Artículos frágiles (el paquete de transporte que contiene artículos frágiles, manipularlo con cuidado)
	Mantener arriba (el paquete de transporte debe estar en posición vertical durante el transporte)
	Evitar la humedad (los embalajes de transporte deben mantenerse secos)
	Límite de temperatura (se debe mantener el rango de temperatura durante el transporte del paquete)
	Corriente alterna
	Puesta a tierra de protección/ (Terminal del conductor de protección)
	Desconectar (la fuente de alimentación principal) / (cortar (la energía)
	Encender (alimentación principal) / (conectar (alimentación)
	Precaución, peligro de descarga eléctrica / (peligro de electricidad)
	Precaución, quemaduras
	Precaución, riesgo de peligro, alerta sobre posibles problemas con el instrumento asociados a su mal uso. Dichos problemas incluyen mal funcionamiento del instrumento, fallas, daños, daños a la muestra o daños a otra propiedad.

Tabla 8. Símbolos y descripción

• **Instrucciones de seguridad**



	<p><b>¡LEA EL MANUAL DEL EQUIPO!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalar y mantener de acuerdo a las instrucciones del fabricante.</li> <li>• Es obligatorio conocer el funcionamiento del equipo antes de proceder a su utilización.</li> <li>• Solo deberán manejar y trabajar con el equipo el personal que esté familiarizado con su manejo y funcionamiento.</li> </ul> <hr/> <p><b>¡LEA LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAYA A UTILIZAR!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es obligatorio conocer la categorización de los productos antes de proceder a su utilización.</li> </ul>
	<p><b>¡ASEGÚRESE DE TRABAJAR EN UN ENTORNO SEGURO!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurarse de que el equipo esté colocado sobre su soporte recomendado, nunca directamente sobre el suelo.</li> <li>• El operador debe estar capacitado, conocer las características de rendimiento del equipo, sus principios de funcionamiento y su funcionamiento in situ, y tener conocimientos específicos del uso del microscopio.</li> <li>• No trabaje solo en el laboratorio sin la supervisión o la autorización del responsable de la actividad.</li> <li>• Abra la caja con cuidado para evitar que los accesorios, como la lente, se caigan al suelo o se dañen.</li> <li>• Mantenga el instrumento alejado de la luz solar directa, altas temperaturas o humedad, y de entornos polvorientos y con vibraciones frecuentes. Asegúrese de que la platina esté plana, horizontal y lo suficientemente firme.</li> <li>• Al mover el microscopio, tómelo con cuidado por el brazo y la base.</li> <li>• Durante el funcionamiento, el portalámparas y las piezas cercanas estarán muy calientes, por lo que evite tocarlas y moverlas.</li> <li>• Asegúrese de que el instrumento esté conectado a tierra para evitar sobrecargas.</li> <li>• Por seguridad, asegúrese de que el interruptor principal esté en la posición “O” (apagado) y corte la alimentación antes de reemplazar la lámpara o el fusible.</li> <li>• Compruebe el voltaje de entrada: asegúrese de que el voltaje de entrada indicado en la parte posterior del microscopio coincida con el voltaje de la fuente de alimentación; de lo contrario, podría dañar el instrumento.</li> <li>• Utilice el cable de alimentación suministrado de fábrica.</li> <li>• Si observa que el equipo funciona de forma anormal, desenchúfelo inmediatamente y apáguelo.</li> <li>• Una vez finalizada su vida útil del equipo, deberá realizarse de acuerdo con las normativas nacionales y regionales de protección ambiental pertinentes, evitando así la contaminación del medio ambiente y la creación de riesgos para la seguridad.</li> </ul>

Tabla 9. Instrucciones de seguridad del microscopio

• **Medidas preventivas de seguridad**




Riesgos		Recomendaciones
	Contacto eléctrico indirecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje nominal del microscopio.</li> <li>• Asegurar que el equipo se encuentra desconectado en operaciones de mantenimiento, ajuste o reparación. Realizar y registrar el mantenimiento preventivo del equipo según las instrucciones del fabricante.</li> <li>• Las operaciones de mantenimiento eléctrico han de ser realizadas por personal técnico autorizado.</li> <li>• No tire del cable de alimentación para desenchufarlo; sujete el enchufe firmemente. Evite que el cable toque superficies calientes o afiladas.</li> <li>• Notificar cualquier incidencia al responsable del equipo.</li> </ul>
	Riesgo biológico, rotura de recipientes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe riesgo de infección al trabajar con muestras biológicas vivas o fijadas si se rompen portaobjetos o se manipulan incorrectamente.</li> <li>• Transmisión de agentes biológicos por contacto con la platina, objetivos o mandos de enfoque si no se desinfectan tras su uso.</li> <li>• La contaminación del aceite de inmersión (al usar el objetivo de 100X), puede convertirse en un vehículo de microorganismos si no se limpia y desinfecta adecuadamente.</li> </ul>
	Riesgo de corte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotura de portaobjetos o cubreobjetos de vidrio durante la preparación o el enfoque, lo que puede causar heridas y aumentar el riesgo de infección si la muestra era biológica.</li> <li>• El mal uso del enfoque grueso con objetivos de alta potencia (40x o 100x) puede romper el portaobjetos y dañar las lentes.</li> </ul>

Tabla 10. Medidas preventivas de seguridad

## **3.3 Operación**

### **3.3.1 Funcionamiento**

#### **1. Instalación y Encendido.**

- 1.1 Coloque el microscopio sobre una superficie plana, estable y limpia.
- 1.2 Conecte el equipo a la red eléctrica y encienda la luz LED mediante el interruptor.
- 1.3 Ajuste el brillo lentamente de oscuro a claro. Al finalizar, disminuya el brillo antes de apagarlo.

#### **2. Preparación de la Muestra.**

- 2.1 Baje la platina mecánica completamente usando el tornillo macrométrico.
- 2.2 Gire el revólver para colocar el objetivo de menor aumento en posición de trabajo.
- 2.3 Coloque la laminilla con la muestra en la platina y asegúrela con las pinzas sujetadoras
- 2.4 Use las perillas de desplazamiento de la platina (ejes X-Y) para centrar la muestra sobre el orificio de luz y en la posición deseada.

#### **3. Enfoque Inicial.**

- 3.1 Con el objetivo de menor aumento, mire por los oculares binoculares y ajuste la distancia interpupilar hasta ver una sola imagen circular.
- 3.2 Observe desde el costado (no por el ocular) y suba la platina con el tornillo macrométrico hasta que la muestra esté cerca del objetivo, cuidando de no chocar.
- 3.3 Ahora, mire por los oculares y gire el tornillo macrométrico lentamente hasta enfocar la muestra.
- 3.4 Use el tornillo micrométrico para lograr la nitidez perfecta e inicie la observación.

#### **4. Cambio de Aumento.**

- 4.1 Gire el revólver al siguiente objetivo. Ajustar únicamente con el tornillo micrométrico para reenfoque.

**Nota:** No use el tornillo macrométrico, ya que puede dañar la muestra o el lente.

- 4.2 Ajuste el diafragma de iris (condensador ABBE NA = 1.25) y el brillo para mejorar el contraste de la muestra.

## **5. Uso de Inmersión en Aceite (Objetivo 100X).**

**5.1** Si requiere el máximo aumento 100X (S, Aceite), gire el revólver entre el 40X y 100X, coloque una gota de aceite de inmersión (sin burbujas) en la laminilla y gire el objetivo 100X hasta que toque el aceite.

**5.2** Enfoque solo con la perilla micrométrica y lleve a cabo las observaciones de su muestra.

## **6. Finalización y Limpieza.**

**6.1** Baje la platina por completo y coloque el objetivo de menor aumento.

**6.2** Retire la muestra.

**6.3** Si usó aceite de inmersión, limpie el lente del objetivo 100X con papel seda para lentes y alcohol isopropílico (90 a 99%) o etanol al 70% (también puede utilizar xileno puro o grado reactivo esporádicamente para una limpieza más profunda cuando sea necesario).

**6.4** Apague la luz y cubra el microscopio con su funda para protegerlo del polvo. Asegúrese de que el portalámparas esté frío antes de cubrirlo.

## 4. Mantenimiento

### 4.1 Guía de solución de problemas

- Sistema óptico.

Problema	Causa	Solución
<b>El borde del campo de visión está oscuro o el brillo no es uniforme.</b>	El revólver no está en la posición correcta (el objetivo y la trayectoria de la luz no son coaxiales).	Coloque la boquilla correctamente donde haga "clic".
	La superficie de la lámpara se vuelve negra.	Cambie la lámpara.
	Una lente (el objetivo, el condensador, el ocular o el colector), está sucia.	Limpiarlo completamente.
<b>Hay suciedad o polvo visible en el campo de visión.</b>	Suciedad / polvo en la muestra	Reemplazar con una muestra limpia.
	Suciedad / polvo en los oculares	Limpiarlo adecuadamente.
<b>La visibilidad es deficiente. La imagen no es nítida. El contraste es deficiente. Los detalles son indistintos.</b>	La muestra no está cubierta.	Coloque el cubreobjetos.
	El grosor del cubreobjetos no es adecuado.	Use un cubreobjetos estándar con un grosor de 0.17 mm.
	La muestra está colocada al revés.	Dar la vuelta.
	El objetivo tiene residuos de aceite.	Limpiar el aceite.
	Una lente (el objetivo, el condensador o el ocular) está sucia.	Limpiarlo adecuadamente.
	No se utiliza aceite de inmersión con el objetivo de 100X.	Use el aceite especificado.
	Había burbujas de aire en el aceite de inmersión.	Elimine las burbujas.
	El diafragma de apertura está demasiado cerrado.	Ajuste correctamente el diafragma de apertura.
<b>Un lado de la imagen está borroso.</b>	Suciedad o polvo en el ocular.	Limpiarlo adecuadamente.
	El condensador no está bien centrado.	Centre el condensador con el tornillo de centrado.
	La boquilla no está bien colocada.	Encaje correctamente la boquilla.
<b>El desplazamiento de la imagen durante el enfoque.</b>	La muestra no está sujeta.	Sujétela con las pinzas de la platina.
	La muestra se resbala en la platina.	Colocar la muestra adecuadamente.
<b>El brillo no es suficiente.</b>	El revólver no está en la posición correcta.	Gírelo a la posición de "clic".
	El diafragma de apertura es demasiado pequeño.	Ajústalo correctamente.
	El condensador está demasiado bajo.	Ajústalo correctamente.
	Una lente (el objetivo, el condensador, el ocular o el colector) está sucia.	Limpiarlo adecuadamente.

Tabla 11. Solución de problemas (Sistema Óptico)

• Sistema mecánico.

Problema	Causa	Solución
La imagen no se puede enfocar.	El ajuste de la altura de la platina, no es correcta.	Ajustar correctamente.
El objetivo entra en contacto con la muestra antes de enfocarla.	La muestra está montada al revés.	Monte la muestra correctamente.
La muestra no se puede mover libremente.	El portaobjetos no está sujeto.	Sujete el portaobjetos firmemente.
El campo de visión de un ojo no coincide con el del otro.	La distancia interpupilar es incorrecta.	Ajuste la distancia interpupilar.
La observación es agotadora.	La dioptría no es la adecuada.	Ajuste la dioptría correctamente.
	El brillo de la iluminación no es adecuado para los ojos.	Ajuste la iluminación de la lámpara.

Tabla 12. Solución de problemas (Sistema Mecánico)

• Sistema eléctrico.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no enciende al encender el interruptor.	No hay corriente.	Verifique la conexión del cable de alimentación.
	La lámpara no sirve.	Reemplazar la lámpara.
La lámpara se apaga repentinamente.	Utiliza una lámpara de baja calidad.	Use la lámpara especificada para reemplazarla. Si el problema no se resuelve, contáctanos a través de <a href="http://www.icb.mx">www.icb.mx</a>
El brillo es insuficiente.	El voltaje es demasiado alto.	Use la lámpara especificada.
La lámpara parpadea o el brillo es vertiginoso.	Utiliza una lámpara de baja calidad.	Aumente el voltaje.

Tabla 13. Solución de problemas (Sistema Eléctrico)

Si alguna de éstas posibles soluciones no arregla el problema, favor de contactarnos a través de [www.icb.mx](http://www.icb.mx)

## **4.2 Mantenimiento preventivo**

Para garantizar una larga vida de Microscopio, es necesario realizar un mantenimiento regular del equipo. Asegúrese siempre de utilizarlo de acuerdo con las siguientes directrices:

- Asegúrese de que todas las lentes estén correctamente ajustadas; no las desmonte solo.
- Opere el microscopio correctamente y coloque la cubierta antipolvo después de trabajar para evitar la entrada de polvo y aceite.
- No desmonte el instrumento precipitadamente, salvo que sea reemplazable, para evitar que se pierda su posición correcta.
- Mantenga el instrumento limpio y no contamine el elemento óptico al limpiar el polvo.
- Mantenga el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de la contaminación y la corrosión.
- Si no va a utilizar los objetivos y oculares durante un período prolongado, colóquelos en una caja sea y coloque la cubierta antipolvo en el microscopio.
- El revólver y las piezas de enfoque grueso y fino son tan delicados que está prohibido desmontarlos sin cuidado.
- Las impurezas como huellas dactilares y manchas de aceite en los oculares o lentes, pueden limpiarse suavemente con un paño suave, papel de seda o gasa humedecida en alcohol isopropílico (90 a 99%) o etanol al 70% (también puede utilizar xileno puro o grado reactivo esporádicamente para una limpieza más profunda cuando sea necesario). Tenga en cuenta que los alcoholes y xileno son altamente inflamables; manténgalos alejados del fuego o de posibles chispas eléctricas y, siempre que sea posible, úselos en una habitación con corrientes de aire.
- No intente utilizar disolventes orgánicos para limpiar los componentes del microscopio (excepto los de vidrio). Para limpiarlos, utilice un paño suave sin pelusa ligeramente humedecido con un detergente neutro diluido.
- Si el microscopio se salpica con algún líquido durante su uso, desconecte la alimentación inmediatamente y limpie la salpicadura.
- No desmonte ninguna pieza del microscopio, ya que esto afectará su funcionamiento o reducirá su rendimiento.
- Para cambiar la lámpara, apague el microscopio y espere a que se enfríe. Asegúrese de cambiar adecuadamente la lámpara con una conexión firme y del centrada.

## 5. Garantía limitada

### 5.1 Política de garantía limitada

*Aplicable solo a productos comercializados por  
Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A de C.V.*

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. garantiza que sus productos estarán libres de defectos de fabricación y funcionarán de acuerdo con las especificaciones establecidas al momento de la compra. Esta garantía será válida por el período de tiempo especificado en la Política de Garantía Limitada, a partir de la fecha de facturación del producto.

#### **Cobertura de la garantía.**

La garantía cubre los defectos de fabricación y los problemas relacionados con el funcionamiento de acuerdo con las especificaciones del producto. Esto incluye problemas de rendimiento durante la duración establecida en la Política de Garantía Limitada.

#### **Duración de la garantía.**

La duración de la garantía varía según el tipo de producto y se establece de la siguiente manera:

- Microscopios: 5 años de garantía.
- Centrífugas: 3 años de garantía.
- Micropipetas: 1 año de garantía.
- Incubadoras, Hornos de Secado, Contadores de células y de colonias, Dispensadores de líquidos, Agitadores Vortex, Agitadores Orbitales, Mezclador de tubos, Agitadores de pipetas, Agitadores de bolsas de sangre, Baños de Agua, Baños secos, Cabinas de bioseguridad, Campanas de flujo laminar, Autoclaves y Liofilizadoras: 2 años de garantía.
- Piezas utilizadas para la reparación de los productos: 1 año de garantía.

La garantía comienza a partir de la fecha de la factura de los productos y se aplica únicamente al propietario original del producto.

#### **Proceso de reclamación de garantía.**

En caso de que un producto esté dentro del período de garantía y se presente un problema cubierto por esta política, el propietario del producto debe seguir los siguientes pasos para presentar una reclamación de garantía:

**a)** Contactar al servicio de atención al cliente de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. por teléfono (+52 33-3628-8333) o correo electrónico ([atencionclientes@icb-mx.com](mailto:atencionclientes@icb-mx.com)) y proporcionar la siguiente información:

- Número de orden o factura de compra.
- Descripción detallada del problema.
- Pruebas o fotografías que demuestren el defecto o mal funcionamiento.

**b)** El número de serie del producto bajo garantía debe coincidir con el número de serie en la factura de compra, y no debe presentar daños ni enmendaduras.

**c)** El servicio de atención al cliente evaluará la reclamación y proporcionará instrucciones adicionales, que pueden incluir la devolución del producto para su reparación o reemplazo.

**d)** En caso de que sea necesario devolver el producto, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. cubrirá los gastos de envío mediante la paquetería que Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. elija, relacionados con la reparación o reemplazo dentro del período de garantía.

### **Soluciones bajo la garantía.**

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho, al aplicar la garantía, de elegir entre las siguientes opciones para solucionar los problemas cubiertos por la garantía:

**a) Reparación:** Si es técnicamente viable y económicamente razonable, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. reparará el producto de forma gratuita utilizando piezas originales o equivalentes, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya terminado.

**b) Reemplazo:** Si la reparación no es posible o no es económicamente viable, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. proporcionará un producto de reemplazo idéntico o similar de igual valor, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya terminado.

**c) Reembolso:** Si ninguna de las opciones anteriores es factible, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. emitirá un reembolso equivalente al precio original de compra del producto, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya terminado.

### **Cláusulas**

**I.** Esta Política cubre los productos adquiridos directamente a través de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

**II.** Esta política de garantía es adicional a los derechos legales del consumidor y no los limita de ninguna manera.

**III.** La política está sujeta a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte nuestro sitio web <https://icb.mx/garantia-icb/> para obtener la información más actualizada.

**IV.** Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del Producto.

**V.** Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

**VI.** El tiempo de reparación del Producto en ningún caso será mayor de 80 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

## **Reparaciones del producto fuera de la Cobertura de garantía.**

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de solucionar los problemas de funcionamiento del producto en caso de no aplicar la Política de Garantía. A continuación, se detallan los procedimientos a seguir:

**a)** Si el producto presenta alguna falla en su funcionamiento, fuera de la Cobertura de la Garantía, el cliente puede enviar el producto a Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. para diagnosticar el problema sin ningún costo de evaluación.

**b)** Para que el producto sea aceptado para revisión y/o reparación en el lugar designado por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V., es necesario obtener una autorización de envío emitida por la misma. Esta autorización se obtendrá mediante la asignación de un número de retorno que Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. proporcionará al cliente. Los gastos de envío y devolución del producto serán cubiertos por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

**c)** Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. proporcionará una hoja de servicio que detallará los fallos encontrados, las posibles causas y las soluciones propuestas para solucionar el problema del producto. Además, se revisarán los daños en el producto para determinar si Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. cubrirá o no los costos de las piezas necesarias para la reparación sin costo adicional para el cliente. La mano de obra requerida para la reparación no tendrá ningún costo para el cliente.

**d)** Mientras el producto esté en proceso de reparación, el cliente tendrá la opción de recibir un producto sustituto y provisional similar al suyo, proporcionado por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V., sin costo alguno. En caso de que el cliente desee recibir un producto sustituto, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. enviará una carta que deberá ser completada y firmada por el cliente para recibir el producto sustituto. El cliente deberá operar el producto sustituto en condiciones óptimas y devolverlo a la empresa siguiendo las indicaciones proporcionadas por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

Los Productos sustitutos estarán sujetos a disposición y disponibilidad. Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de proporcionar y elegir el producto sustituto en caso de haber disponibilidad.

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar el método mediante el cual se proporciona el servicio, así como los requisitos que debe cumplir su Producto para recibir dicho servicio.

## **Exclusiones.**

Esta garantía no se aplica a productos que no sean comercializados por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

La garantía no se aplica a ninguna otra circunstancia que no esté relacionada con un defecto de fabricación.

Esta garantía no aplica:

- a) a piezas consumibles, como baterías, fusibles o revestimientos de protección que están diseñados para desgastarse con el tiempo;
- b) a daños superficiales, incluidos, entre otros, rayones, abolladuras y roturas de plásticos, metales y estampas o etiquetas;
- c) a daños causados por el uso con un componente o producto de terceros que no cumpla con las especificaciones de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.;
- d) a daños causados por accidentes, abuso, uso indebido, incendios, terremotos, alzas de voltaje, u otras causas externas;
- e) a daños causados por usar el equipo de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. sin respetar las normas de seguridad;
- f) a daños causados por el desgaste normal o atribuibles al efecto del paso del tiempo;
- g) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las establecidas por el manual de operación del Producto;
- h) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo del Producto (manuales de operación en nuestra página <https://icb.mx/>);
- i) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. o el comercializador responsable respectivo;
- j) Si se eliminó o se borró cualquier número de serie del Producto;
- k) Si no dispone de ningún medio para probar que es el usuario autorizado del equipo (por ejemplo, no puede presentar la prueba de compra);
- l) Cuando el Producto se hubiese descalibrado o requiera renovación de certificaciones;
- m) Si el Producto sufre daños causados por el envío;
- n) Cuando el cliente no sigue las instrucciones de uso, instalación o mantenimiento otorgado por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

**Importante:** No intente abrir los Productos, pues puede provocar daños que no están cubiertos por esta Garantía. Solo Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. debe realizar reparaciones de los productos en garantía.

## **Limitaciones de Responsabilidad**

La responsabilidad de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. bajo esta garantía se limita únicamente a la reparación, reemplazo o reembolso según lo establecido en esta política. En ningún caso, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. será responsable por daños incidentales, consecuentes, indirectos o especiales que puedan surgir como resultado del uso o la imposibilidad de usar el producto cubierto por esta garantía.

## **Modificaciones de la Política de Garantía**

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de esta política de garantía en cualquier momento y sin previo aviso. Las modificaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el sitio web de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

## **Generalidades**

Ningún distribuidor, agente o empleado de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. está autorizado para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta Garantía. En caso de que algún término se considere ilegal o imposible de exigir, la legalidad y la exigibilidad de los términos restantes no se verán afectadas ni disminuidas. Esta Garantía se rige e interpreta de acuerdo con las leyes mexicanas.

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información sobre nuestra política de garantía, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. C. Volcán Paricutín #5103, Colli Urbano 1ra sección, 45070 Zapopan, Jal. México. Teléfono: 52 (33)-3628-8333. Correo electrónico: [atencionclientes@icb-mx.com](mailto:atencionclientes@icb-mx.com)

## 6. Anexos

### 6.1 Aplicaciones del microscopio


Aplicación	Descripción
Universidades y educación	Es una herramienta esencial para la enseñanza y la investigación en diversas disciplinas como la biología, medicina, bioquímica y ciencias ambientales. Permite a los estudiantes y científicos observar estructuras celulares, tejidos, microorganismos y otros componentes biológicos con gran detalle, fomentando la comprensión de conceptos teóricos, el desarrollo de habilidades de observación y análisis, y la exploración científica.
Laboratorios clínicos	Es una herramienta esencial para el diagnóstico y la investigación médica. Permite examinar muestras biológicas como sangre, tejidos y microorganismos a nivel microscópico, revelando detalles que no son visibles a simple vista.
Hospitales y clínicas	Es una herramienta esencial para el diagnóstico, investigación y tratamiento de diversas enfermedades. Se utiliza para examinar muestras de tejidos, células sanguíneas, microorganismos y otros materiales biológicos con el fin de identificar patologías y guiar decisiones médicas.
Industria farmacéutica	Son ampliamente utilizados en diversos sectores de la salud: Medicina: los microscopios se utilizan para exámenes de laboratorio, especialmente para estudiar muestras y detectar la presencia de patógenos como microbios, bacterias u otros microorganismos mortales.
Laboratorios de microbiología	Es una herramienta esencial para observar y estudiar microorganismos, como bacterias, hongos y parásitos, que son invisibles a simple vista. Permite ampliar la imagen de estos microorganismos, distinguir detalles finos de su estructura y analizar sus características morfológicas, lo que es crucial para la identificación, diagnóstico y estudio de estos organismos.
Centros de investigación	Es una herramienta esencial para observar y analizar estructuras a nivel microscópico, permitiendo el estudio de células, tejidos, microorganismos y moléculas.
Industria cosmética	Permite analizar la piel y el cabello a nivel microscópico para el desarrollo de productos más efectivos y seguros. Se utiliza para examinar la textura de la piel, la distribución de partículas en emulsiones, la salud de los folículos pilosos y la presencia de microorganismos, entre otros.
Veterinaria	Permite el examen de muestras biológicas para el diagnóstico de diversas enfermedades y afecciones en animales. Se utiliza para analizar tejidos, fluidos corporales (sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, etc.), e incluso muestras de piel o pelo.
Laboratorios de alimentos	Se utiliza para examinar la composición y calidad de los alimentos a nivel microscópico, identificando microorganismos, evaluando la estructura de los alimentos y controlando la calidad. Esto incluye la identificación de bacterias, levaduras y mohos, así como la evaluación de la estructura de componentes como el almidón en granos, etc.
Biología	Permite la observación de estructuras celulares y moleculares, así como para el estudio de procesos biológicos. Permite investigar la estructura y función de las células, visualizar interacciones celulares y analizar procesos dinámicos como la división celular y la señalización. Además, es fundamental en el diagnóstico de enfermedades, el desarrollo de tratamientos y la investigación en áreas como la microbiología y la inmunología.

Tabla 14. Aplicaciones del microscopio

  
**Garantía**  
**5 años**

# Microscopio Prisma 208-T

MTTP104126

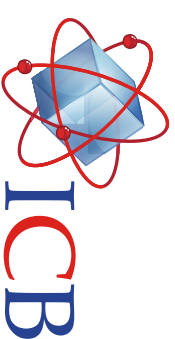

## Descripción

El Microscopio Prisma 208-T, es un instrumento óptico con cabezal Trinocular Siedentopf para un enfoque de alta calidad, adaptable a cabezales binoculares y trinoculares, inclinados a 30° y puede adaptarse una Pantalla LCD de alta definición. Cuenta con objetivos planos infinitos de alta calidad, revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra, condensador ABBE N.A.=1.25 y lámpara LED con brillo ajustable. Es un instrumento esencial para exámenes, demostraciones educativas, bacteriología y citoscopia en universidades, centros médicos, institutos de investigación y departamentos de silvicultura y agricultura, entre otros.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Cabezal	Trinocular	-
Ocular	WF10X/Ø22	mm
Objetivos de Plano Infinito	4X, 10X, 40X(S) y 100X (S, Aceite)	-
Platina	Medidas: 175x145 Movimiento: X-Y 76x50	mm
Revolver	Cuádruple	-
Enfoque	Rango: 25	mm
Condensador	ABBE N.A.= 1.25	-
Iluminación	LED 5W Brillo ajustable	W
Alimentación	110/60	V/Hz



## Características


- Cabezal Trinocular Siedentopf inclinado a 30° para un enfoque de alta calidad.
- Se adapta a cabezales binoculares o trinoculares inclinados a 30°.
- Objetivos de plano infinito y oculares de campo amplio.
- Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con tope de seguridad.
- Revolver cuádruple, con rotación cómoda y precisa que facilita el cambio de muestra.
- Moderno brazo en arco para una mejor visualización, ergonomía y comodidad.
- Platina Mecánica de doble capa, con vernier y pinza para una operación fácil.
- Objetivos con anillos de color para su fácil identificación durante su operación.
- Iluminación Koehler LED 5W con brillo ajustable, luz eficiente y prolongada.
- Condensador ABBE N.A.=1.25 con diafragma de iris para una observación detallada.
- Conector que permite adaptar una Pantalla LCD de alta definición.
- Base robusta, diseñado para uso prolongado para distintas áreas de aplicación.

## Accesorios Incluidos

- Muestra de aceite de inmersión.
  - Juego de Llaves Allen.
  - Funda.
  - Cable de alimentación (110V 60Hz).
- ¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!

## 6.2 Ficha técnica



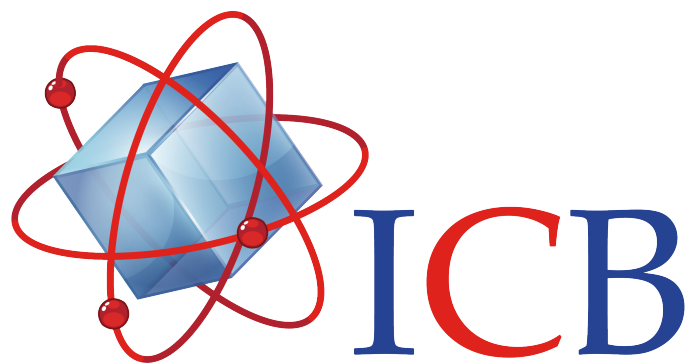

Ingeniería Científica  
Bionanomolecular S.A. de C.V.

**Contacto:**

Conmutador: (33)36288333  
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>  
E-mail: [atencionclientes@icb-mx.com](mailto:atencionclientes@icb-mx.com)

Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección,  
Zapopan, Jalisco 45070